

V Praze dne 2. 6. 2011

Věc: dodatečné informace

Dle § 49 zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na dodávku ve zjednodušeném podlimitním řízení „**Dodávka multifunkční aparatury na TPR/TPD/TPO techniky**“, které byly zpracovány na základě došlých e-mailových dotazů ke dni 2. 6. 2011

---

*Dotaz č. 1:*

- *žádáme Vás tímto o zaslání zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Dodávka multifunkční aparatury TPR/TPD/TPO techniky“ ve formě použitelné pro vyplnění, kopírování, překlad apod., například \*.doc.*

Odpověď na dotaz č. 1:

- na webové stránky jsme přidali navíc zadávací dokumentaci v elektronické podobě s přílohou doc, která umožní uchazečům s textem pracovat.

*Dotaz č. 2:*

- *lze pro prokázání dodávky nad 2 miliony uvést dodávku na Slovensko a zda-li to může být i jiná instrumentální technika – např. termická analýza?*

Odpověď na dotaz č. 2:

- dodávku na Slovensko lze uvést do požadovaného přehledu a výše uvedenou techniku lze uvést k prokázání zakázek nad 2 milióny.

*Dotaz č. 3:*

- *je interní míchání podmínkou?*

Odpověď na dotaz č. 3:

- v ÚCHP máme rozvody čistých plynů, míchané bomby nepoužíváme; omezují možnost experimentů na jeden složkový poměr. Všechny aparatury jsou vybaveny

průtokoměry, které umožňují nastavitelné míchání jednotlivých složek v jakémkoliv žádaném poměru. Využití předem připravených směsí plynů v bombách je omezující a neekonomické. Z těchto důvodů je interní míchání podmínkou. Rozhodnutí, zda se zúčastníte výběrového řízení, je zcela ve Vaší kompetenci.

*Odpověď na dotaz č. 4:*

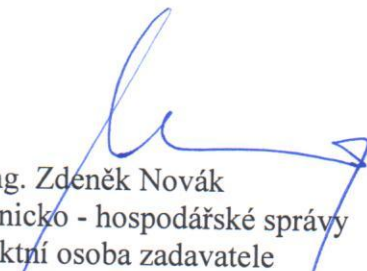
- *je-li požadován i hmotnostní spektrometr, aby byl zahrnut do nabídky nebo pouze možnost připojení k MS či je postačující detekce s TCD?*

Odpověď na dotaz č. 4:

- hmotnostní spektrometr není požadován, stačí pouze možnost jeho připojení. Postačující je detekce s TCD.

Uvedené dotazy a odpovědi budou dnem 3. 6. zveřejněny na webových stránkách zadavatele.

Odpověďi zpracoval:

  
Ing. Zdeněk Novák  
vedoucí technicko - hospodářské správy  
kontaktní osoba zadavatele

**ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR, v. v. I.**  
162 02 Praha 6 - Suchbát, Rozvojevá 135  
IČO: 67985858 DIČ: CZ67985858